



ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE



Este ficheiro foi traduzido automaticamente e pode conter informações incompletas, falsas ou enganosas.

Use com cautela e consulte as versões em inglês ou alemão.

Em caso de dúvida, entre em contacto com a [KELLER Pressure](#).

Obrigado.



Série 10L

Cápsula de transdutor de pressão piezorresistiva com estabilidade ideal

Características

- Estabilidade a longo prazo ideal
- Caixa robusta em aço inoxidável
- Diafragma soldado, nivelado com a face frontal e sem fendas
- Pressão de prova muito elevada
- Comportamento térmico otimizado

Tecnologia

- Chip de sensor de pressão piezorresistivo, isolado e encapsulado numa caixa metálica cheia de óleo
- Ideal para montagem com anel O-ring
- Intervalo típico do sinal de saída de 160 mV/mA

Aplicações típicas

- OEM
- Indústria
- Laboratório

Precisão

± 0,25 %FS

Estabilidade a longo prazo


± 0,15 %FS/ano

Intervalos de pressão


0...0,1 bar a 0...200 bar



Série 10L

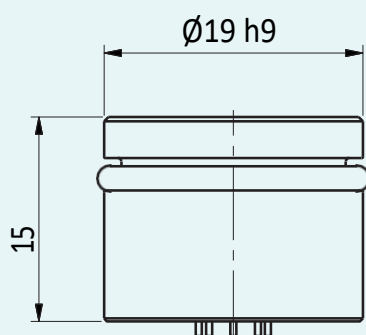

Esquema elétrico da ponte de medição com compensação

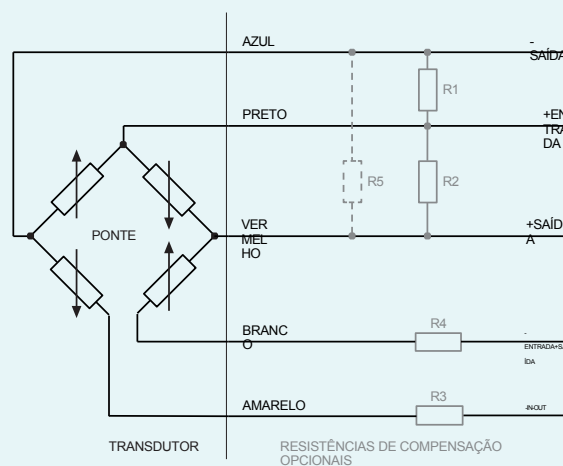

Série 10L – Especificações

Intervalos de pressão padrão

Pressão relativa		Absoluta pressão	Absoluta pressão	Prova pressão	Sensibilidade		
PR		PAA	PA		mín.	típica	máx.
-0,1...0,1	0...0,1	0...0,1		3	98	130	163
-0,2...0,2	0...0,2	0...0,2					
-0,3...0,3	0...0,3	0...0,3					
-0,5...0,5	0...0,5	0...0,5					
-1...0	0...1	0...1	0...1	6	60	80	100
-1...1	0...2	0...2	0...2	9	40	53	66,7
-1...2	0...3	0...3	0...3				
	0...5	0...5	0...5	15	24	32	40
	0...10	0...10	0...10	30	12	16	20
	0...20	0...20	0...20	60	6	8	10
	0...30	0...30	0...30	90	4	5,3	6,7
	0...50	0...50	0...50	150	2,4	3,2	4
		0...100	0...100	300	1,2	1,6	2
		0...160	0...160		0,75	1,0	1,25
		0...200	0...200				
bar rel.		bar abs.	bar	bar	mV/(mA × bar)		
Pressão de referência à pressão atmosférica		Pressão de referência a 0 bar abs. (vácuo)	Pressão de referência a 1 bar abs.	Com base na pressão de referência	As gamas de pressão padrão estão disponíveis em stock. Também é possível efetuar calibrações para quaisquer gamas de pressão intermédias.		

Desempenho

Precisão à temperatura ambiente (20...25 °C)	± 0,25 %FS (típica)	Não-linearidade (retângulo de melhor ajuste BFSL), histerese de pressão, não-repetibilidade
	± 0,50 %FS máx.	
Desvio à temperatura ambiente (20...25 °C)	< ± 25 mV/mA	Sem compensação; o valor da sensibilidade deve ser adicionado para PA.
	< ± 2 mV/mA	Compensado com R3 ou R4.
Intervalo de temperatura compensado	-10...80 °C	São possíveis outras faixas de temperatura entre -55...150 °C como opção.
Estabilidade a longo prazo	≤ ± 0,15 %FS	Para faixas de pressão > 1 bar, por ano em condições de referência.
	≤ ± 1,5 mbar	Para faixas de pressão ≤ 1 bar, por ano em condições de referência.
Dependência da posição	≤ 2 mbar	Calibrado na posição de instalação vertical, com o diafragma metálico virado para baixo.
Resistência ao vácuo		As faixas de pressão de 0,1/0,2/0,3/0,5 bar abs. são, de série, otimizadas para vácuo. Para todas as outras faixas de pressão, recomenda-se a versão otimizada para vácuo para pressões de funcionamento ≤ 0,1 bar abs.
Coeficiente de temperatura zero (TCzero) pré-compensado com R1 ou R2	≤ ± 0,015 %FS/K	Para faixas de pressão ≥ 2 bar
	≤ ± 0,3 mbar/K	Para faixas de pressão < 2 bar
Sensibilidade do coeficiente de temperatura TCsens	≤ ± 0,06 %/K	Para faixas de pressão ≥ 3 bar
	≤ ± 0,12 %/K	Para faixas de pressão < 3 bar
Coeficiente de temperatura da resistência total da ponte (TC-resistência)	1800...3000 ppm/K	

Série 10L – Especificações

Dados elétricos

Configuração de meia-ponte

Alimentação de corrente constante	1 mA nominal 3 mA máx.	
Resistência da ponte à temperatura ambiente (20...25 °C)	3,5 kΩ ± 20 %	
Ligação elétrica	Pinos banhados a ouro com Ø 0,45 mm L = 4 mm ± 0,5 mm	Opcional: Fios de silicone AWG28 (0,09 mm²), L = 70 mm, outros comprimentos a pedido.
Isolamento	> 100 MΩ a 500 VCC	

Dados mecânicos

Materiais em contacto com os fluidos

Caixa e diafragma	Aço inoxidável AISI 316L	
O-ring	Ø 15,6 mm × 1,78 mm FKM (75 Shore) 20...200 °C	Para temperaturas do fluido < -20 °C, utiliza-se FVMQ.

Outros materiais

Enchimento com óleo da cápsula do transdutor de pressão	Óleo de silicone
---	------------------

Mais detalhes



Diâmetro × altura	Ø 19 mm × 15 mm	Ver dimensões e variantes
Ligação para capilar para compensação da pressão de referência	Ø 1,2 mm × 3 mm	Opcional: Capilar (silicone)
Peso	aprox. 25 g	

Condições ambientais


Intervalo de temperatura do meio	-40...125 °C		Temperatura de funcionamento, ter em conta o o-ring. Não é permitido a formação de gelo.
Intervalo de temperatura ambiente	-40...125 °C		
Intervalo de temperatura de armazenamento	-40...125 °C		
Resistência à vibração	10 g, 10...2000 Hz, ± 10 mm	IEC 60068-2-6	
Resistência ao choque	50 g, 6 ms	IEC 60068-2-27	
Frequência natural (ressonância)	> 30 kHz		
Resistência à fadiga à temperatura ambiente (20...25 °C)	> 10 milhões de ciclos de pressão	0...100 %FS	
Variação do volume morto à temperatura ambiente (20...25 °C)	< 2 mm³		

Série 10L – Dimensões e variantes

Visão geral das versões

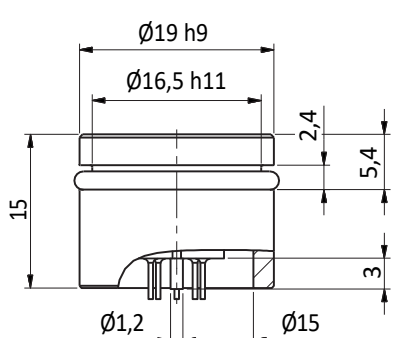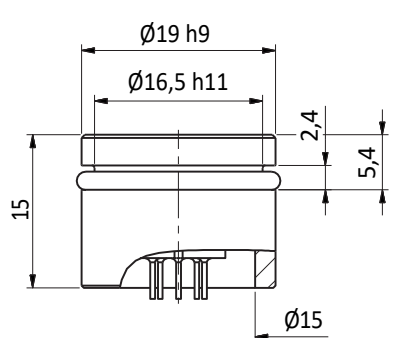PR	PAA/PA
	

Ligação elétrica

Ligação com passagem de vidro		Atribuição de pinos da ponte de medição semiaberta			
		PIN	Rótulo	Designação	Cor do fio
		1	+OUT	Saída positiva	vermelho
		2	+IN	Alimentação positiva	preto
		3	-SAÍDA	Saída negativa	azul
		4	-IN-OUT	Alimentação negativa (meia ponte -OUT)	amarelo
		5	-IN+OUT	Alimentação negativa (meia ponte +OUT)	branco

Configurações personalizadas a pedido

- Calibração para outras gamas de pressão
- Calibração para outras gamas de temperatura entre -55...150 °C
- Calibração com modelação matemática
- Ligação elétrica através de fios de silicone
- Caixa e diafragma em Hastelloy C-276 ou titânio
- O-rings fabricados em outros materiais
- Outros tipos de enchimento de óleo para a cápsula do transdutor de pressão
- Versão otimizada para vácuo para pressões de funcionamento $\leq 0,1$ bar abs., a pedido
- Adaptações a aplicações específicas do cliente

Exemplos de produtos semelhantes

- Série 10LHP: Versão de cápsula de transdutor de alta pressão para intervalos de pressão > 200 bar
- Série PD-10L: Versão em cápsula do transdutor de pressão diferencial
- Série 10LX: Com eletrónica de compensação digital
- Série 4L...9L: Designs mais compactos

Série 10L – Análise e linhas características

Análise padrão

Os modelos da série 10L destinam-se à montagem com anéis de vedação e dependem do isolamento de tensão proporcionado por estes para o desempenho dentro das especificações indicadas. Esta instalação permite que os valores medidos durante os testes de fábrica se mantenham válidos. Se os transdutores de pressão não forem instalados isentos de tensão, as forças mecânicas podem alterar os valores medidos e a estabilidade.


Ficha de calibração: Exemplo do tipo PA-10L					Chave				
PA-10L / 10 bar / 10-1005-118 (1) Sn I107547 (2) 449 (3) Temp [°C] (4) Zero [mV] (5) +510 [mV] (6) Comp [mV] (7) dZero [mV] 29/01 -9,5 18,5 13,3 -0,6 0,2 0,1 18,7 13,3 -0,6 0,2 25,0 19,1 13,1 -0,8 0,0 50,2 19,8 13,0 -0,9 -0,1 79,9 20,8 12,9 -1,1 -0,2 L1 COMP R1 510 kOhm (8) R3 56,0 ohms (9) RB 3482 ohms (9) P_atm 964 mbar ZERO -0,8 mV (10) SENS 16,41 mV/bar (11) LIN (12) [bar] (13) [mV] (14) Lnorm [%Fs] (15) Lbfs [%Fs] 0,000 0,0 0,00 -0,01 2,500 41,1 0,02 0,01 5,000 82,1 0,00 0,00 7,500 123,1 -0,02 -0,01 10,000 164,1 -0,01 -0,01 Estabilidade a longo prazo: em ordem (16) Lote 72114-2 (17) Teste a 500 volts: OK (18) Alimentação de 1,000 mA (19) 01.09.17 (20) GOL3.A03D1K (20) <tr><td colspan="5"> 1. Tipo (PA-10L) e intervalo de medição (10 bar) 2. Número de série 3. Temperaturas reais de ensaio 4. Desvio do zero não compensado 5. Valores de desvio do zero com resistência de compensação calculada R1 (+) ou R2 (-) 6. Valores de desvio do zero com as resistências de compensação calculadas R1 ou R2 e R3 ou R4 7. Erro de zero de temperatura com resistências de compensação calculadas 8. Valores calculados das resistências de compensação R1 ou R2 (TCzero) e R3 ou R4 (desvio) 9. RB: Resistência da ponte à temperatura ambiente 10. Desvio calculado com as resistências de compensação R1 ou R2 e R3 ou R4 11. Sensibilidade à temperatura ambiente de 25 °C 12. Pontos de teste de pressão 13. Variação do sinal nos pontos de ensaio de pressão à temperatura ambiente de 25 °C 14. Não linearidade (melhor reta que passa por zero) 15. Não linearidade (melhor reta) 16. Resultado do ensaio de estabilidade a longo prazo 17. Número de lote e identificação da pastilha de silício 18. Teste de isolamento 19. Excitação (corrente constante) 20. Data do teste-----Equipamento de ensaio </td></tr>					1. Tipo (PA-10L) e intervalo de medição (10 bar) 2. Número de série 3. Temperaturas reais de ensaio 4. Desvio do zero não compensado 5. Valores de desvio do zero com resistência de compensação calculada R1 (+) ou R2 (-) 6. Valores de desvio do zero com as resistências de compensação calculadas R1 ou R2 e R3 ou R4 7. Erro de zero de temperatura com resistências de compensação calculadas 8. Valores calculados das resistências de compensação R1 ou R2 (TCzero) e R3 ou R4 (desvio) 9. RB: Resistência da ponte à temperatura ambiente 10. Desvio calculado com as resistências de compensação R1 ou R2 e R3 ou R4 11. Sensibilidade à temperatura ambiente de 25 °C 12. Pontos de teste de pressão 13. Variação do sinal nos pontos de ensaio de pressão à temperatura ambiente de 25 °C 14. Não linearidade (melhor reta que passa por zero) 15. Não linearidade (melhor reta) 16. Resultado do ensaio de estabilidade a longo prazo 17. Número de lote e identificação da pastilha de silício 18. Teste de isolamento 19. Excitação (corrente constante) 20. Data do teste-----Equipamento de ensaio				
1. Tipo (PA-10L) e intervalo de medição (10 bar) 2. Número de série 3. Temperaturas reais de ensaio 4. Desvio do zero não compensado 5. Valores de desvio do zero com resistência de compensação calculada R1 (+) ou R2 (-) 6. Valores de desvio do zero com as resistências de compensação calculadas R1 ou R2 e R3 ou R4 7. Erro de zero de temperatura com resistências de compensação calculadas 8. Valores calculados das resistências de compensação R1 ou R2 (TCzero) e R3 ou R4 (desvio) 9. RB: Resistência da ponte à temperatura ambiente 10. Desvio calculado com as resistências de compensação R1 ou R2 e R3 ou R4 11. Sensibilidade à temperatura ambiente de 25 °C 12. Pontos de teste de pressão 13. Variação do sinal nos pontos de ensaio de pressão à temperatura ambiente de 25 °C 14. Não linearidade (melhor reta que passa por zero) 15. Não linearidade (melhor reta) 16. Resultado do ensaio de estabilidade a longo prazo 17. Número de lote e identificação da pastilha de silício 18. Teste de isolamento 19. Excitação (corrente constante) 20. Data do teste-----Equipamento de ensaio									

Notas

- As especificações indicadas aplicam-se apenas a uma alimentação de corrente constante de 1 mA. O módulo do transdutor de pressão não deve ser alimentado com mais de 3 mA. A tensão de saída é proporcional à corrente de alimentação. Se a alimentação se desviar da calibração, isso provocará desvios no sinal.
- As resistências de compensação descritas nesta ficha técnica não fazem parte do módulo transdutor de pressão e não estão incluídas no âmbito de fornecimento.
- Recomenda-se a utilização de resistências de compensação com coeficientes de temperatura < 50 ppm/°C para amplas faixas de temperatura. Os módulos transdutores de pressão e as resistências podem ser expostos a temperaturas diferentes.
- Além disso, é possível garantir uma sensibilidade máxima ao TC a pedido ou indicar o valor do resistor de compensação (R5). Consulte «Esquema elétrico dos resistores de compensação» na página 1.

Curvas características

Exemplos de curvas características típicas dos coeficientes de temperatura, normalizadas a 25 °C, não compensadas vs. compensadas.

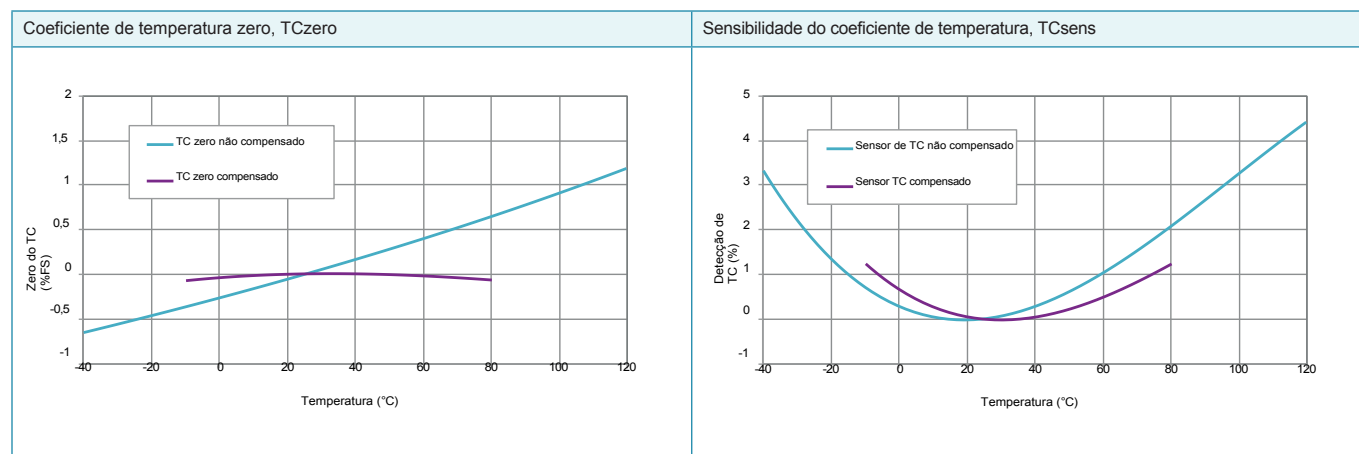

Série 10L – Análise e linhas características

Modelo de compensação matemática

Os transdutores de pressão da série 10L podem ser encomendados com um modelo de compensação matemática opcional.

O modelo de compensação é uma fórmula matemática que ajuda a calcular o valor de pressão compensado do transdutor de pressão. Tanto o sinal de pressão como o sinal de temperatura do transdutor de pressão são incorporados no cálculo. São utilizadas funções polinomiais como base para este modelo matemático.

Os transdutores de pressão são caracterizados na fábrica para criar o modelo de compensação. Isto envolve a medição dos sinais de pressão e temperatura a vários níveis de pressão e temperatura. A comparação dos valores medidos com os valores conhecidos de pressão e temperatura permite calcular os coeficientes de compensação do transdutor de pressão. Estes coeficientes de compensação são disponibilizados ao cliente juntamente com o respetivo transdutor de pressão.



myCalibration

Conteúdo

O myCalibration é uma plataforma de dados digital disponibilizada gratuitamente aos clientes da KELLER Pressure. Oferece uma opção simples para transferir e disponibilizar dados de calibração de sensores.

Formato

Os dados de calibração estão disponíveis no formato de ficheiro JSON padrão, o que facilita a integração harmoniosa no software do cliente. A estrutura do ficheiro está claramente definida num esquema JSON acessível ao público. Isto significa que o cliente pode integrar os dados de forma harmoniosa no seu software.

Acesso

É possível aceder à plataforma através de um navegador da Web padrão (visualização Web) ou diretamente no software do cliente, utilizando uma API. Os dados de calibração permanecem disponíveis no myCalibration durante 24 meses.

Aplicação web

Os clientes podem aceder aos dados de calibração dos seus sensores através de uma interface intuitiva. O sistema garante uma autenticação segura, solicitando aos utilizadores que introduzam os seus dados de acesso pessoais, impedindo assim o acesso não autorizado aos dados por parte de terceiros.

O utilizador tem a opção de utilizar várias funções de pesquisa e filtragem para descarregar dados de calibração de sensores específicos ou exportar em massa vários conjuntos de dados simultaneamente.

API

Os clientes têm a opção de utilizar a API REST para acesso automatizado e para a integrar nos seus processos. Isto significa que os dados de calibração de novos sensores podem ser acedidos automaticamente e, em seguida, processados, por exemplo.

Documentação

Está disponível documentação técnica abrangente, incluindo software de exemplo, na seguinte ligação: <https://mycalibration.github.io/>